



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1135—2008
代替 YY 91135—1999

骨 剪

Bone scissor

2008-10-17 发布

2010-01-01 实施

国家食品药品监督管理局 发 布

前 言

本标准代替 YY 91135—1999《骨剪》。

本标准与 YY 91135—1999 相比主要变化如下：

——标准中扩充了骨剪的型式；

——标准按 YY 1122—2005《咬骨钳(剪)通用技术条件》的规定，重新进行了修订。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。


本标准由上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂负责起草。

本标准主要起草人：刘伟群。


本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——YY 91135—1999；

——WS2-222—1976。

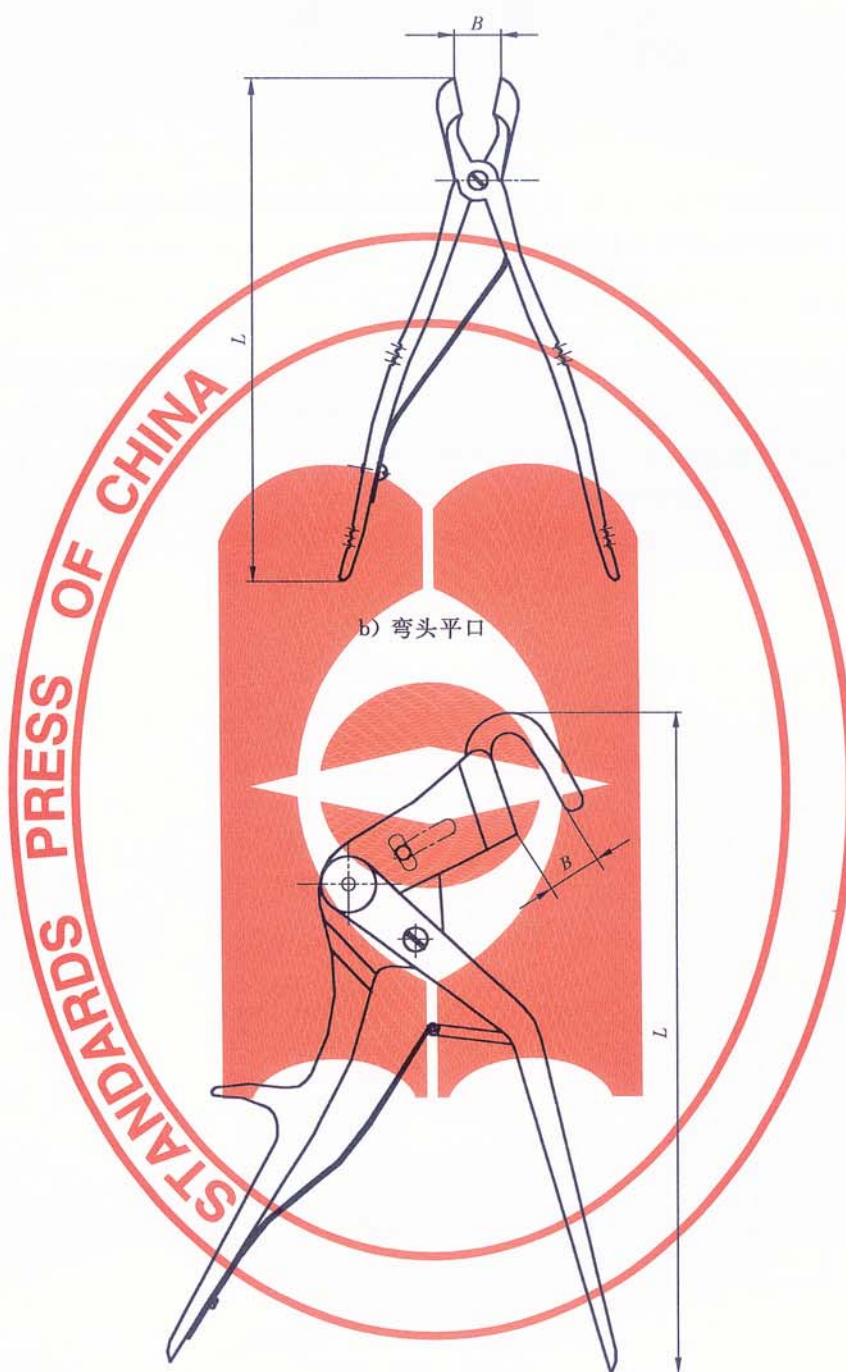


c) 胸骨
图 1 (续)

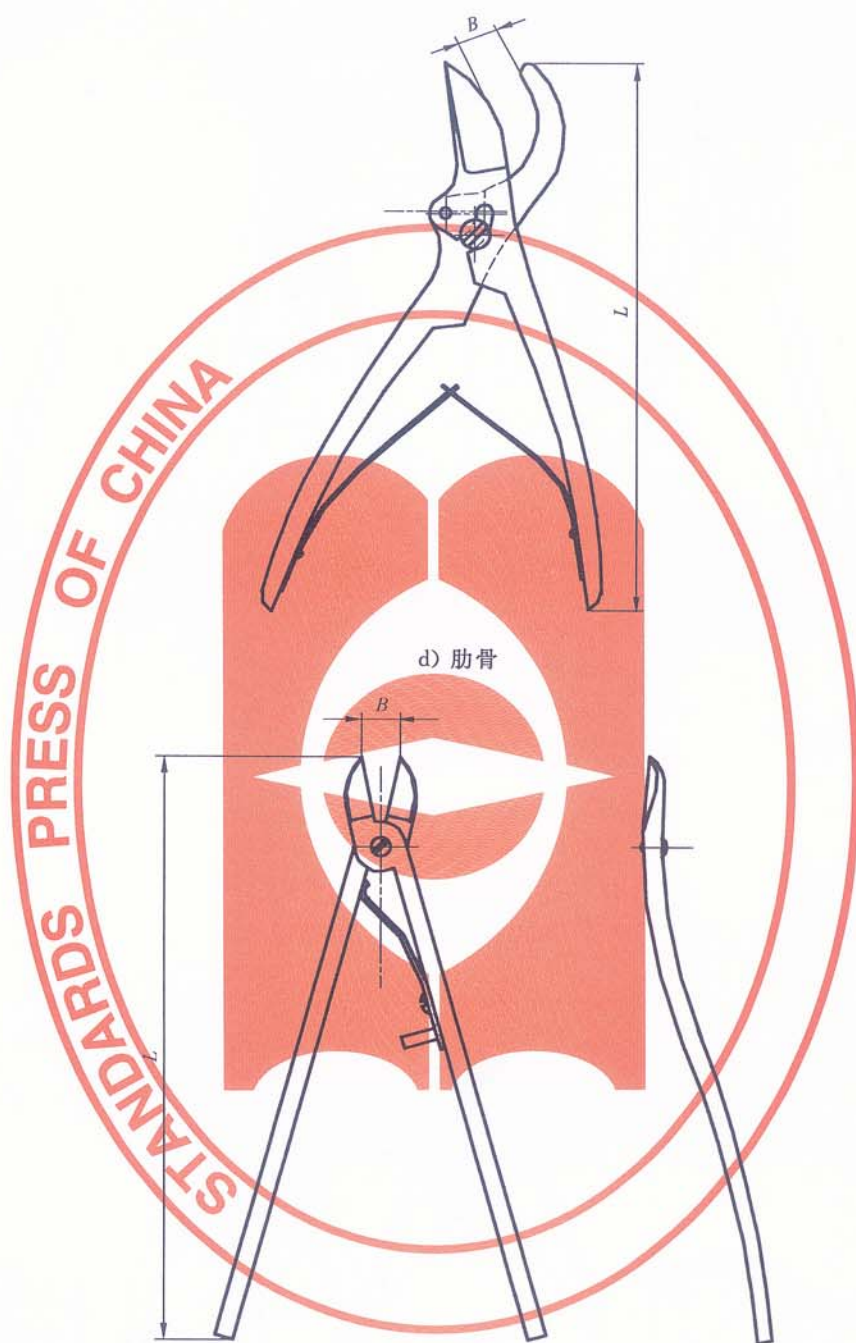


e) 长肋骨


图 1 (续)

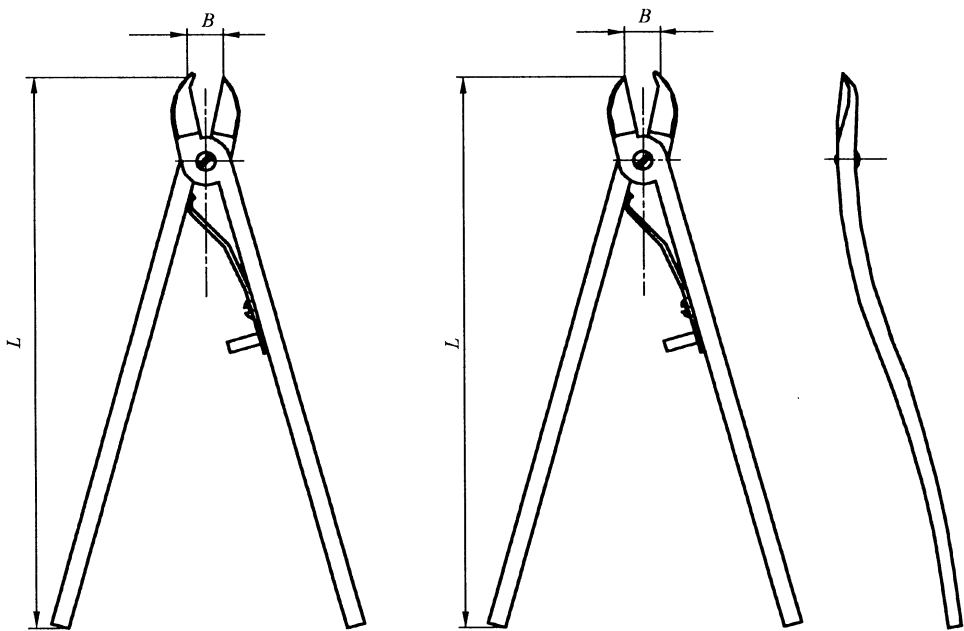

f) 左钩长肋骨、右钩长肋骨
图 1 (续)

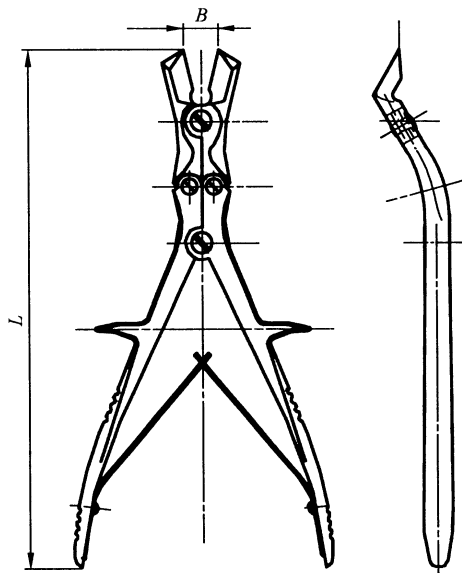

a) 棘突
图 2 骨剪(双关节)

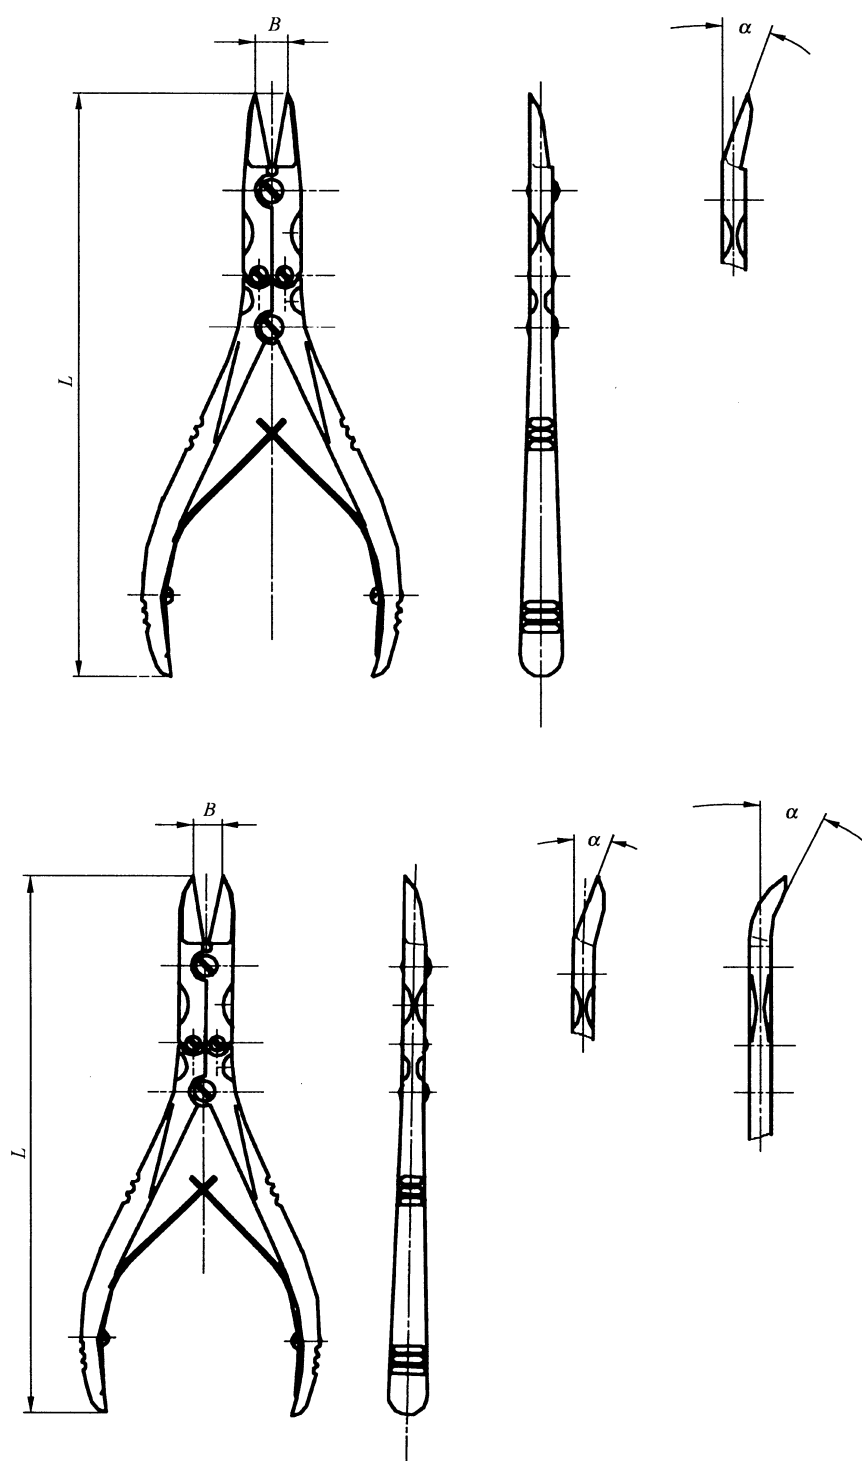

b) 直尖、弯尖、直圆、弯圆、弯圆口

图 2 (续)

表 1 基本尺寸

单位为毫米

型 式		L/mm	$B(\text{头部张开尺寸})/\text{mm}$	α
单关节	直圆、弯圆、弯圆口	120~200	≥ 12	$0^{\circ}\sim 30^{\circ}$
	弯头平口	200~240	≥ 20	—
	胸骨	200~240	≥ 12	—
	肋骨	220(闭合尺寸)	≥ 18	
	长肋骨	340(闭合尺寸)	≥ 18	
	左钩长肋骨 右钩长肋骨			
双关节	棘突	240~260	≥ 12	$0^{\circ}\sim 40^{\circ}$
	直尖、弯尖 直圆、弯圆 弯圆口	170~280	≥ 10	

3.2 骨剪的头部可选用 GB/T 1220 中规定的 30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13 材料,也可选用符合第 4 章要求的其他材料。

4 要求

4.1 骨剪的尺寸应符合表 1 中 B 的规定。

4.2 骨剪的其余要求应符合 YY 1122—2005 中第 4 章的规定。

5 试验方法

骨剪的试验方法应符合 YY 1122—2005 中第 5 章的规定。

6 检验规则

骨剪的检验规则应符合 YY 1122—2005 中第 6 章的规定。

7 标志、使用说明书

骨剪的标志、使用说明书应符合 YY 1122—2005 中第 7 章的规定。

8 包装、运输、贮存

骨剪的包装、运输、贮存应符合 YY 1122—2005 中第 8 章的规定。

中 华 人 民 共 和 国 医 药
行 业 标 准
骨 剪
YY/T 1135—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*


开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 13 千字
2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19587 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

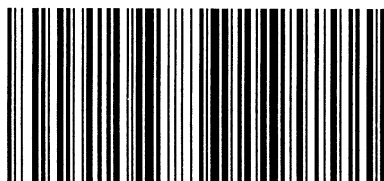

YY/T 1135-2008